




四季の風 第3号



透析用水製造の構成

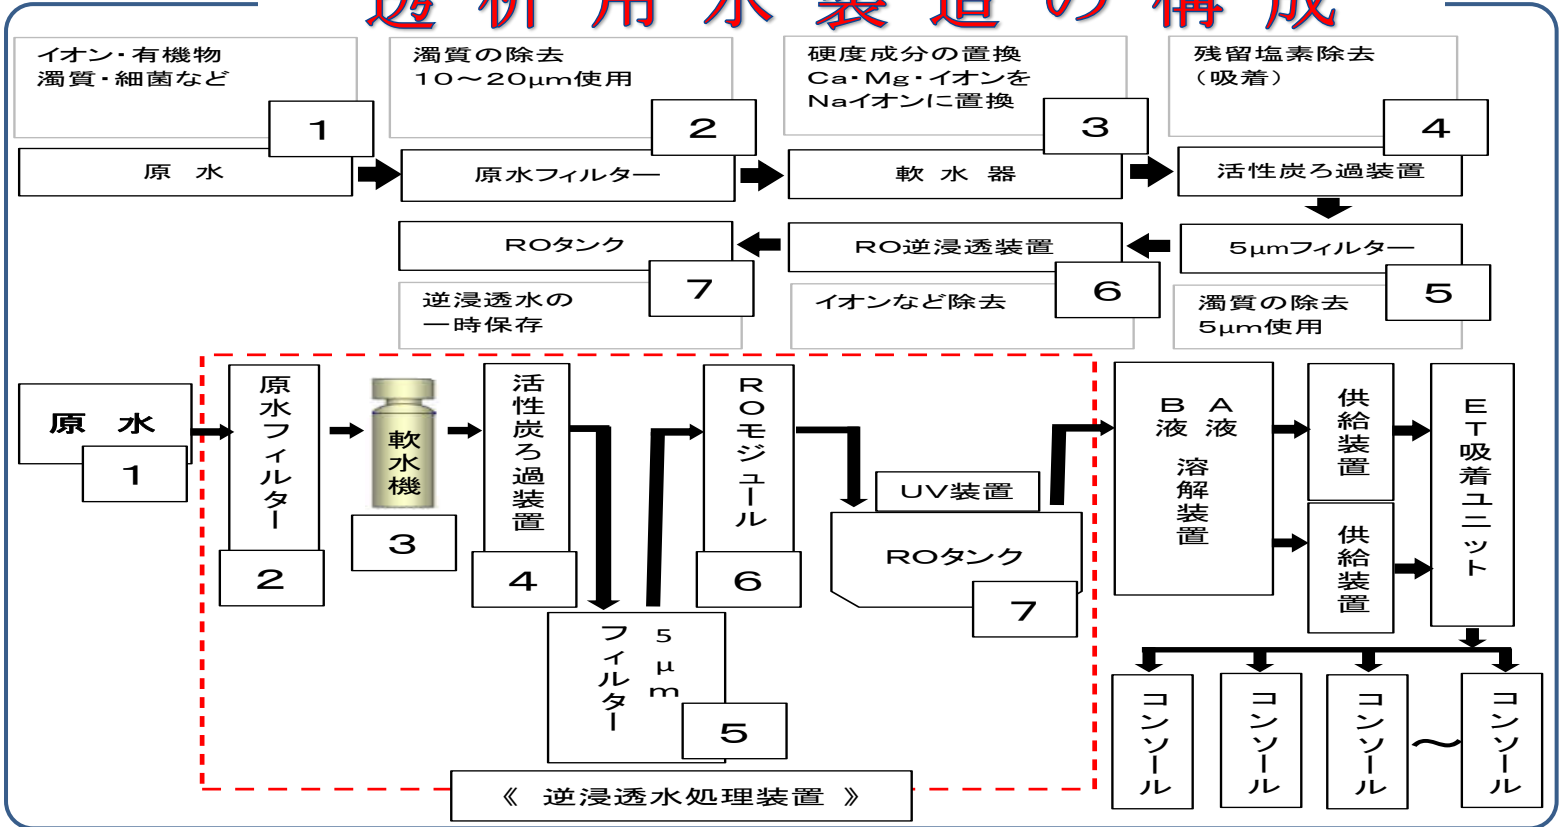

透析液水質基準

透析用水	ET: 0.050 CFU/ml 未満
	細菌: 100 EU/ml 未満
標準透析液	ET: 0.050 CFU/ml 未満
	細菌: 100 EU/ml 未満
超純粋透析液	ET: 0.001 EU/ml 未満
	細菌: 0.1 CFU/ml 未満
オンライン透析液	ET: 0.001 EU/ml 未満
	細菌: 10 ⁻⁶ CFU/ml 未満

当院における透析液清浄化システム

臨床工学技士

当院は機器設置時クリーンな透析液を供給する為に添加物を全く含まない高純度二フッ化樹脂 (PVDF) の配管を使用、薬品、食品、半導体など工場の超純粋ラインに使用されているもので九州管内の施設でも数少ない配管を使用しています。接合部に継ぎ目を作らない工法で施工、微生物の付着、増殖の低減、流速を停滞させないなど配管の汚染防止に努め、安全治療を行う事の出来る透析液を供給しています。

透析精製ルームで希釈、調整され2台の供給装置で送液され、ベッド頭上のカウンター内に配管が走っており患者監視装置へと液が送られます。1人当たり1回4時間の透析で約1200強の透析液を使っています。

日本臨床工学技士会の『透析液清浄化ガイドライン』の厳しい水質基準に沿って、院内に『透析機器安全管理委員会』を設置し、水質管理の年間計画を立て、月1回以上の水質検査を行い、1年間でROタンク・各コンソールの水質検査を行っております。



介護保険について

☆介護保険とは☆

介護保険は、高齢者が自立した生活を送ることが出来るよう身体・精神・経済面の不安を社会全体で支えていく制度です。40歳以上の方が加入し、介護を受ける際には所得に応じて費用の1割もしくは2割を利用者が負担します。介護保険を利用するまでの流れとして、お住まいの市町村の介護保険担当課等で申請をし、職員による認定調査、主治医による意見書作成により要介護度が決定、介護度に応じてサービス利用開始となります。


☆サービスの種類☆

◎自宅に訪問してもらう	訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーションなど
◎施設に通う	通所介護・通所リハビリテーションなど
◎通い中心の複合サービス	小規模多機能型居宅介護・複合型サービス
◎短期間施設に泊まる	ショートステイ・医療型ショートステイ
◎移り住んで利用する	グループホーム・特定施設入居者生活介護など
◎介護保険施設に入所	介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設
◎生活環境を整える	福祉用具レンタル、購入・住宅改修

※介護度や市町村によって、受けられるサービスが異なります。

☆最後に☆

少しでも自分らしい生活が長く送られるよう介護保険制度を上手に活用し、いつまでも元気に生活していきたいものです。また、ご家族の介護をされている方も、この制度を利用することにより介護の負担軽減ができます。介護でお困りの方で、まだ介護保険を利用されていない方は一度お住まいの市町村に相談してみてもいいでしょう。

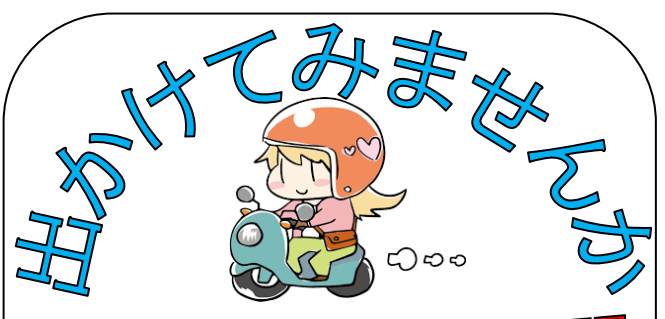

今回は、西大山駅



2003年に沖縄の赤嶺駅が開業するまでは日本最南端の駅でした。以前 テレビの「人生の楽園」でも紹介された駅です。私が行った時、人が多いと思ったらツアーで日本一周をしている団体さんでした。鐘・黄色のポストなどがあります。なぜか伍代夏子の歌碑(金木屋)もあります。

